


Invacare® Etude Plus

Etude Plus, Etude Plus Low

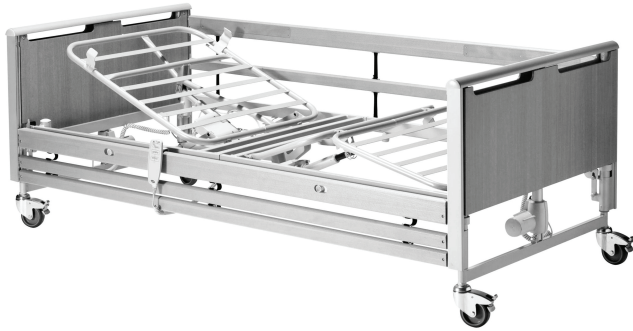

no Seng
Bruksanvisning

Denne bruksanvisning skal overleveres til sluttbrukeren.
FØR du bruker dette produktet, MÅ du lese denne bruksanvisning
og oppbevare den til senere referanse.



Yes, you can.®

©2023 Invacare Corporation

Med enerett. Republisering, duplisering eller modifisering helt eller delvis er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Invacare på forhånd. Varemerker angis med ™ og ®. Alle varemerker eies av eller er lisensiert til Invacare Corporation eller tilhørende datterselskaper med mindre annet er angitt.

Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon	4
1.1 Innledning	4
1.1.1 Symboler i dette dokumentet	4
1.2 Tiltent bruk	4
1.2.1 Tiltent operatør	4
1.3 Levetid	4
1.4 Samsvar	5
1.4.1 Produktspesifikke standarder	5
1.5 Garantiopplysninger	5
1.6 Ansvarsbegrensning	5
2 Sikkerhet	6
2.1 Generell sikkerhetsinformasjon	6
2.2 Madrasser	7
2.3 Sikkerhetsinformasjon om elektromagnetisk kompatibilitet	7
2.4 Merking og symboler på produktet	8
2.4.1 Identifikasjonsmerke	8
2.4.2 Annen merking	8
3 Montering	10
3.1 Generell sikkerhetsinformasjon	10
3.2 Ved mottak av sengen	10
3.3 Annet	10
3.4 Montering av sengen	10
3.4.1 Feste etiketter	11
3.5 Kontrollboks	11
3.6 Kabling	11
3.7 Montering av sengegrinder	12
3.7.1 Scala 2 sengegrind	12
3.7.2 Sengegrindene Britt V og Line	12
3.8 Demontere sengen	13
4 Betjene sengen	14
4.1 Generell sikkerhetsinformasjon	14
4.1.1 Lave høyder	14
4.1.2 Madrasstøtter	14
4.2 Håndkontroll	14
4.2.1 Låsefunksjon	14
4.3 Hjul og sentralbrems	15
4.3.1 Hjulbrems	15
4.4 Bruk av sengegrind	15
4.4.1 Bruk av Scala 2 sengegrind	15
4.4.2 Sengegrindene Line og Britt V	16
4.5 Løftebøyle	16
4.5.1 Plasser løftebøylen	16
4.5.2 Justering av håndtakshøyde	16
4.6 Justere benseksjonen	16
4.7 Nødposisjoner	17
4.7.1 Nødsenking av en liggeflatedel	17
4.8 Liggeflateforlenger	17
4.9 Transport og oppbevaring	17
5 Ekstraustyr	18
5.1 Liste over tilgjengelig tilbehør	18
5.2 Transportbraketter	18
6 Vedlikehold	19
6.1 Generell vedlikeholdsinformasjon	19
6.2 Daglige inspeksjoner	19
6.3 Generell serviceinformasjon	19
6.3.1 Sjekkliste for vedlikehold	19
6.4 Inspeksjon etter flytting – klargjøre for ny bruker	19
6.4.1 Sjekkliste – etter flytting	19
6.5 Rengjøring og desinfisering	20
6.5.1 Generell sikkerhetsinformasjon	20
6.5.2 Rengjøringshyppighet	20
6.5.3 Rengjøring for hånd	20
6.5.4 Instruksjoner for desinfisering	20
6.6 Smøring	20
7 Etter bruk	21
7.1 Avfallshåndtering	21
7.2 Overhaling	21
8 Feilsøking	22
8.1 Feilsøking av elektrisk system	22
9 Tekniske Data	23
9.1 Materialer	23
9.2 Dimensjoner	23
9.3 Vekt	23
9.4 Madrass	23
9.5 Miljøbetingelser	24
9.6 Elektrisk system	24
10 Elektromagnetisk kompatibilitet	25
10.1 Generell EMC-informasjon	25
10.2 Elektromagnetisk utslipp	25
10.3 Elektromagnetisk immunitet	25
10.3.1 Testspesifikasjoner for immunitet for trådløst RF-kommunikasjonsutstyr	26

1 Generell informasjon

1.1 Innledning

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet håndteres. Les bruksanvisningen nøye, og følg sikkerhetsinstruksjonene i den, slik at du kan bruke produktet på en trygg måte.

Du må kun bruke dette produktet hvis du har lest og forstått denne bruksanvisningen. Be om råd hos helsepersonell som har kjennskap til den medisinske tilstanden din, og avklar eventuelle spørsmål du måtte ha om riktig bruk og nødvendige justeringer, med helsepersonellet.

Vær oppmerksom på at det kan være deler av dette dokumentet som ikke er relevante for produktet ditt, ettersom dokumentet gjelder for alle tilgjengelige modeller (på trykkesidspunktet). Hvis ikke annet er angitt, viser hvert avsnitt i dette dokumentet til alle modeller av produktet.

De tilgjengelige modellene og konfigurasjonene i ditt land, står oppgitt i de landsspesifikke salgsdokumentene.

Invacare forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Før du leser dette dokumentet, må du forsikre deg om at du har den nyeste versjonen. Du finner den nyeste versjonen som en PDF-fil på Invacare-nettstedet.

Hvis skriftstørrelsen i den trykte versjonen av dokumentet er vanskelig å lese, kan du laste ned PDF-versjonen fra nettstedet. Deretter kan du skalere PDF-en, slik at skriftstørrelsen passer bedre for deg.

Hvis du ønsker mer informasjon om produktet, som f.eks. produktsikkerhetsmerknader og tilbakekalling, kan du kontakte en Invacare-forhandler. Se adresser nederst i dette dokumentet.

Dersom det skjer en alvorlig hendelse i tilknytning til produktet, bør du informere produsenten og de kompetente myndigheter i landet ditt.

1.1.1 Symboler i dette dokumentet

I dette dokumentet brukes bestemte symboler og varselsord for å angi farer eller utrygge fremgangsmåter som kan medføre personskade eller skade på eiendom. Nedenfor finner du definisjoner av disse symbolene.



ADVARSEL

Angir en farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller død dersom den ikke unngås.



FORSIKTIG

Angir en farlig situasjon som kan føre til lettere skade dersom den ikke unngås.



LES DETTE

Angir en risikofylt situasjon som kan føre til skade på materiell dersom den ikke unngås.



Tips og anbefalinger

Gir nyttige tips, anbefalinger og opplysninger når det gjelder effektiv og problemfri bruk.

Andre symboler

(Gjelder ikke alle håndbøker)



Ansvarlig UK angir om et produkt ikke er produsert i Storbritannia.



Triman

Angir resirkulerings- og sortereregler (gjelder bare for Tyskland).

1.2 Tiltent bruk

Denne medisinske sengen har elektrisk styring, kan justeres i høyden og har en profilert liggeflate beregnet for bruk sammen med en madrass. Medisinske senger er designet for å støtte pasienten og brukes for reduksjon, lindring og rehabilitering av enkelte medisinske tilstander. Den medisinske sengen forenkler også arbeidsforholdene for omsorgspersoner.

Den medisinske sengen er beregnet for:

- *Bruksområde 3:* Langtidspleie i et medisinsk miljø, hvor tilsyn av helsepersonell er påkrevd og overvåking utføres ved behov, og hvor medisinsk elektrisk utstyr kan bli benyttet i medisinske prosedyrer for å bidra til å opprettholde eller forbedre pasientens tilstand.
- *Bruksområde 4:* Pleie som gis i et hjemmemiljø hvor medisinsk elektrisk utstyr blir benyttet for å lindre eller oppveie for en skade, tapt funksjonsevne eller sykdom.

Tiltente brukere

En person som har en medisinsk tilstand som krever pleie i en seng.

Indikasjoner

Sengen er beregnet på voksne brukere med en kroppslengde på 146 cm eller mer, en vekt på 40 kg eller mer og en kroppsmasseindeks (BMI) på 17 eller mer.

Sengen er bare beregnet på innendørs bruk.

Maksimal brukervekt er 165 kg og sikker arbeidsbelastning er 200 kg.

Kontraindikasjoner

Sengen er ikke beregnet på transport av brukere. Den er flyttbar innenfor et rom med en bruker oppi. Hjulene kan låses.

Sengen er ikke beregnet på personer med psykososial funksjonsnedsettelse.



ADVARSEL!

Dersom den brukes på en annen eller feilaktig måte, kan dette føre til farlige situasjoner.

Invacare erkjenner ikke ansvar for annen type bruk, endring eller montering enn det som er angitt i denne bruksanvisningen.

1.2.1 Tiltent operatør

Tiltente personer for betjening av dette produktet er helsepersonell eller privatpersoner som har fått riktig opplæring.

Håndkontrollen kan også betjenes av brukeren som ligger i sengen.

1.3 Levetid

Forventet levetid for dette produktet er syv år når det brukes daglig i samsvar med instruksjonene om sikkerhet,

vedlikehold og riktig bruk i denne bruksanvisningen. Den faktiske levetiden varierer etter brukshyppighet og -intensitet.

1.4 Samsvar

Kvalitet er avgjørende for virksomheten til selskapet, som arbeider innenfor fagområdene i ISO 13485.

Dette produktet er CE-merket i samsvar med EU-forordning 2017/745 om medisinsk utstyr, klasse I.

Dette produktet er UKCA-merket, i samsvar med del II av UK MDR 2002 (som endret), klasse I.

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at selskapets påvirkning på miljøet – både lokalt og globalt – reduseres til et minimum.

Vi bruker kun materialer og komponenter som er i samsvar med REACH-forskriftene.

Vi overholder de gjeldende miljøregelverkene WEEE og RoHS.

1.4.1 Produktspesifikke standarder

Produktet er testet og samsvarer med IEC 60601-2-52 (spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og viktig ytelse for medisinske senger) og alle relaterte standarder.

Kontakt din lokale Invacare-representant for ytterligere informasjon om lokale standarder og regelverk. Se adresser nederst i dette dokumentet.

1.5 Garantiopplysninger

Vi tilbyr en produsentgaranti for produktet i samsvar med våre generelle forretningsvilkår i det aktuelle landet.

Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle leverandøren av produktet.

1.6 Ansvarsbegrensning

Invacare erkjenner ikke ansvar for skade som skyldes:

- Manglende overholdelse av instruksjonene i bruksanvisningen
- Feil bruk
- Naturlig slitasje
- Feilmontering utført av kjøperen eller en tredjepart
- Tekniske endringer
- Endringer som ikke er godkjent, og/eller bruk av uegnede reservedeler

2 Sikkerhet

2.1 Generell sikkerhetsinformasjon

Denne delen av håndboken inneholder generell sikkerhetsinformasjon om produktet. Mer detaljert sikkerhetsinformasjon finner du i de relevante delene av håndboken og i prosedyrene som er beskrevet i de delene.



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller skade på utstyr

- Du må ikke bruke dette produktet eller annet tilgjengelig ekstrautstyr hvis du ikke først har lest og forstått disse instruksjonene og eventuelt tilleggsmateriale, for eksempel bruksanvisninger eller instruksjonsdokumenter som følger med dette produktet eller ekstrautstyr. Hvis du har problemer med å forstå advarslene, forsiktighetsreglene eller instruksjonene, tar du kontakt med helsepersonell, en Invacare-leverandør eller en kvalifisert tekniker før du forsøker å bruke produktet.
- Ikke foreta endringer på produktet uten tillatelse.



ADVARSEL!

Klem- og kvelningsfare

Det er klem- og kvelningsfare dersom kroppsdeler kommer mellom liggeflaten, sengegrinden og endegavlen, eller mellom deler i bevegelse og gjenstander nær sengen.

- Sengen må ikke brukes av personer som er under 12 år, eller av personer med en kroppsstørrelse som er lik eller mindre enn den til en gjennomsnittlig 12-åring.
- Sengen i kombinasjon med sengegrinder skal ikke brukes av personer med kroppslengde mindre enn 146 cm, kroppsvekt mindre enn 40 kg eller kroppsmasseindeks (BMI) mindre enn 17.
- Over tid kan risikoen øke fordi madrassen blir mer sammentrykt. Sjekk regelmessig avstandene mellom seng, madrass og sengegrind. Erstatt madrassen dersom avstandene øker klemfare.



ADVARSEL!

Fare for å gli gjennom åpninger

Sengen oppfyller alle krav til maksimumsavstand. Hvis sengen benyttes til personer som er små av vekst, er det imidlertid en fare for at pasienten kan gli gjennom åpningen mellom sengegrinden og liggeflaten.

- Vær spesielt oppmerksom dersom sengen brukes til personer med liten kroppsstørrelse.



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller skade på utstyr

Feil håndtering av ledninger, feilaktige tilkoblinger og bruk av uautorisert utstyr kan føre til elektrisk støt og produktsvikt.

- Ikke knyt, kutt eller skad produktets ledninger på noen måte.
- Sørg for at ingen kabler havner i klem eller blir skadet under bruk.
- Ta støpselet ut av stikkkontakten før sengen flyttes.
- Forsikre deg om at kabelføringen er korrekt, og at koblingene sitter godt.
- Ikke bruk utstyr som ikke er godkjent.



ADVARSEL!

Fare for snubling, innvikling eller kvelning

Feil ruting av laderens ledninger kan føre til fare for snubling, innvikling eller kvelning.

- Forsikre deg om at alle kabler er rutet og festet som de skal.
- Kontroller at det ikke er noen sløyfer med ekstra kabel som strekker seg ut fra produktet.



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller skade på utstyr

Tennkilder kan forårsake forbrenning eller brann.

- Sengen må plasseres med en sikkerhetsavstand til mulige tennkilder (ovn, peis osv.).
- Pasienten og ledsagerne må ikke røyke mens han/hun bruker eller betjener sengen.



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller skade på utstyr

For å unngå personskade eller skade på utstyr ved bruk av produktet:

- Bruk i nærheten av barn eller kjæledyr krever nøye tilsyn.
- Ikke la barn leke med produktet.



FORSIKTIG!

- Senk alltid sengen til en passende høyde når brukeren skal opp i eller ut av den. Ryggledelen av liggeflaten kan brukes som hjelp når man skal inn i eller ut av sengen. Sørg for at pasienten legges ned midt på ryggledelen. Når ryggledelen heves, er maksimumsvekten for ryggledelen 45 % av maks. sikker arbeidsbelastning.
- Senk alltid sengen ned til laveste posisjon før du forlater en person i sengen uten tilsyn.
- Kontroller at det ikke er noe under, over eller i nærheten av sengen som kan hindre høydejusteringen, for eksempel møbler, personløftere eller vinduskarmer.

**FORSIKTIG!**

Ikke-originalt eller feil tilbehør kan påvirke funksjonen og sikkerheten til produktet.

- Bruk bare originalt tilbehør for det aktuelle produktet.
- På grunn av regionale forskjeller, må du se din/ditt lokale Invacare-katalog eller -nettsted for tilgjengelig tilbehør eller kontakte din lokale Invacare-representant. Se adresser nederst i dette dokumentet.

**FORSIKTIG!****Risiko for personskade eller skade på utstyr**

Produktet kan bli varmt dersom det utsettes for sollys eller andre varmekilder.

- Ikke utsett produktet for direkte sollys i lengre perioder.
- Hold produktet unna varmekilder.

**FORSIKTIG!**

Det er en fare for at fingre kan komme i klem i sengens bevegelige deler.

- Pass på fingrene dine.

**LES DETTE!**

Sengen har ikke isolator (hovedbryter). Hvis sengen skal kobles fra strøm, skal det skje ved at støpselet kobles fra stikkontakten.

- Plasser alltid sengen slik at stikkontakten er lett tilgjengelig for å koble fra sengen.

**LES DETTE!**

Oppsamling av lo, støv og annen skitt kan skade produktet.

- Hold produktet rent.

2.2 Madrasser

**ADVARSEL!****Sikkerhetsaspekter ved kombinering av sengegrinder og madrasser:**


For å oppnå så høy sikkerhet som mulig er det viktig å overholde minimums- og maksimumsmålene for madrasser når det brukes sengegrinder i sengen.

- Korrekte madrassmål finner du i madrastabellen i kapittel 9 *Tekniske Data*, side 23.

**ADVARSEL!****Klem- og kvelningsfare**

– Brukeren kan komme i klem og/eller bli kvalt dersom det er for stor vannrett klaring mellom madrassiden og innsiden av sengegrinden. Overhold minimumsbredden (og -lengden) for madrasser i kombinasjoner med sengegrinder som er angitt i madrastabellen i kapittel 9 *Tekniske Data*, side 23.

- Vær oppmerksom på at svært tykke eller myke madrasser (med lav tetthet) eller en kombinasjon av slike, øker faren.

**ADVARSEL!****Risiko for å falle**

Brukeren kan falle over kanten og bli alvorlig skadet dersom den loddrette avstanden [Ⓐ] mellom toppen av madrassen og kanten på sengegrinden/endegavlen er for kort. Se bildet ovenfor.

- Overhold alltid en minimumsavstand [Ⓐ] på 22 cm.
- Overhold maksimumshøyden for madrasser i kombinasjon med sengegrinder som er angitt i madrastabellen i kapittel 9 *Tekniske Data*, side 23.

2.3 Sikkerhetsinformasjon om elektromagnetisk kompatibilitet

**ADVARSEL!****Risiko for funksjonssvikt på grunn av elektromagnetisk forstyrrelse**

Elektromagnetisk forstyrrelse mellom dette produktet og annet elektrisk utstyr kan oppstå og forstyrre de elektriske justeringsfunksjonene for dette produktet. For å forhindre, redusere eller eliminere slik elektromagnetisk forstyrrelse:

- Bruk bare originalkabler, -tilbehør og -reservedeler for at elektromagnetisk utslipp ikke skal økes eller redusere dette produktets elektromagnetiske immunitet.
- Ikke bruk bærbart, radiofrekvent (RF) kommunikasjonsutstyr nærmere enn 30 cm fra noen del av dette produktet (inkludert kabler).
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av høyfrekvent kirurgisk utstyr og RF-skjermet rom i et system for magnetisk resonansavbilding der det er høy intensitet i elektromagnetiske forstyrrelser.
- Hvis det skjer forstyrrelser, øk avstanden mellom dette produktet og annet utstyr eller slå det av.
- Se den detaljerte informasjonen og følg veiledningen i kapittel 10 *Elektromagnetisk kompatibilitet*, side 25.



ADVARSEL!

Risiko for funksjonssvikt på grunn av elektromagnetisk forstyrrelse

En bør helst unngå å bruke dette utstyret ved siden av eller oppå annet utstyr, da det kan resultere i svekkede funksjoner. Hvis slik bruk er nødvendig, må sengen og annet utstyr observeres nøye for å kontrollere at de fungerer som de skal. Denne medisinske sengen kan brukes sammen Invacare-godkjent-tilbehør med medisinsk elektrisk utstyr som er koblet til hjertet (intrakardialt) eller til blodkarene (intravaskulært), forutsatt at det tas hensyn til følgende punkter:

- Medisinsk elektrisk utstyr skal ikke festes på sengens metalleder, for eksempel på sengegrindene, løftebøylen, dryppstangen, endegavlene osv.
- Strømledningen til det medisinske elektriske utstyret bør holdes unna sengens ekstrautstyr og andre bevegelige deler.

2.4 Merking og symboler på produktet

2.4.1 Identifikasjonsmerke

Identifikasjonsmerket er plassert på sengerammen og inneholder de viktigste produktopplysningene, inkludert tekniske data.

	Serienummer
	Referansenummer
	Produsent
	Produksjonsdato
	Medisinsk utstyr
	Maks. brukervekt
	Maks. tillatt arbeidsbelastning
	Klasse II-utstyr
	Type B-kontakt del

	WEEE-samsvar
	EU
	Storbritannias samsvarsvurdering



Forkortelser for tekniske data:


- lin = inngangsstrøm
- Uin = inngangsspenning
- Int. = intermittens
- AC = vekselstrøm
- Max = maksimum
- min = minutter


For mer informasjon om tekniske data, se 9 *Tekniske Data*, side 23.

2.4.2 Annen merking



Les bruksanvisningen før du bruker dette produktet, og følg alle instruksjonene for sikkerhet og bruk.	
	Definisjon av minimumsvekt, minimumshøyde og minimum kroppsmasseindeks for en voksen bruker. Se <i>Tiltenkt bruk</i> .
	Se brukerdokumentasjonen for korrekte madrassmål. Se 9 <i>Tekniske Data</i> , side 23.
	Produktets totale vekt, inkludert maksimale trygge arbeidslast
	Temperaturgrense
	Fuktighetsbegrensning
	Atmosfærisk trykkgrense

	Betingelser for oppbevaring og transport
	Betingelser for bruk

	
Angir områder med økt risiko for å klemme føttene på de nedre sidene av endegavlene nær styrehjulene.	
Se 4.1.1 Lave høyder, side 14	
(Bare tilgjengelig på de lave versjonene av dette produktet)	


Viser avtakbare deler med en masse på mer enn 20 kg. Se 9 Tekniske Data, side 23.

Merking på sengegrinder i 3/4 lengde

 
Indikerer maksimal avstand mellom sengegrinden og endegavlens ved hodeenden på sengen.
Se monteringsanvisningen i denne håndboken eller bruksanvisningen som leveres med sengegrinden.

3 Montering

3.1 Generell sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller skade på utstyr

- Skadede deler kan påvirke produktets sikkerhet.
- Før produktet tas i bruk må det kontrolleres at ingen av delene har blitt skadet under frakt.
 - Hvis du oppdager skade, må produktet ikke brukes. Kontakt Invacare-leverandøren for ytterligere instruksjoner.



ADVARSEL!

Skaderisiko for personer eller materiell


- Montering av sengen og dens tilbehør må kun utføres av en kvalifisert tekniker eller en person som har fått forsvarlig opplæring.
- Følg anvisningene nøye. Hvis du har spørsmål om monteringen, ta kontakt med din Invacare leverandør.
 - Sengens elektriske utstyr må ikke demonteres eller brukes sammen med annet elektrisk utstyr.
 - Etter hver montering må du kontrollere at alle beslag og fester er godt festet, og at alle delene fungerer slik de skal.



LES DETTE!

- Sengen bør ikke tas i bruk før den har nådd driftstemperatur, for å unngå kondensering. Se 9 Tekniske Data, side 23

3.2 Ved mottak av sengen

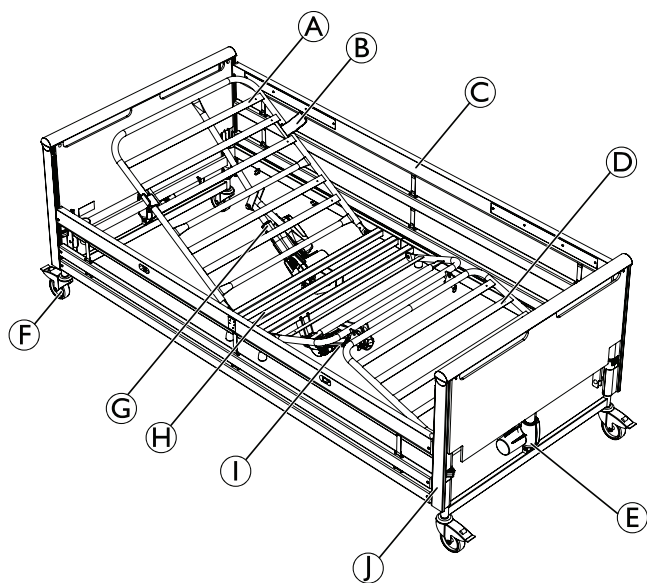

Produktleveranse:

- Ⓐ Liggeflate, endegavl en ved hodeenden
- Ⓑ Madrassholdere, 4 stk.
- Ⓒ Sidegrinder (tre eller stål), 2 stk.
- Ⓓ Liggeflate, hodeende
- Ⓔ Motor til endegavl
- Ⓕ Styrehjul, 4 stk.

- Ⓖ Motor til endegavl en ved hodeenden
- Ⓘ Motor til fotgavl
- ⓵ Endegavl, 2 stk.
- Håndkontroll (ikke vist)

Valgfritt

- ⓗ Liggeflateforlenger (10 eller 20 cm)
- Løftebøyle
- Transportbeslag



Sidegrinder er muligens ikke en del av konfigurasjonen. Dersom du ønsker mer informasjon om sidegrinder og annet tilbehør, kan du kontakte din Invacare-representant.

3.3 Annet

Følgende produkter leveres også innenfor leveringsområdet:

Del	Antall
Bruksanvisning	1
Klemfare	4


3.4 Montering av sengen



ADVARSEL!


- Etter hver montering må du kontrollere at alle festedeler er korrekt tilstrammet, og at alle delene fungerer slik de skal.

Liggeflate

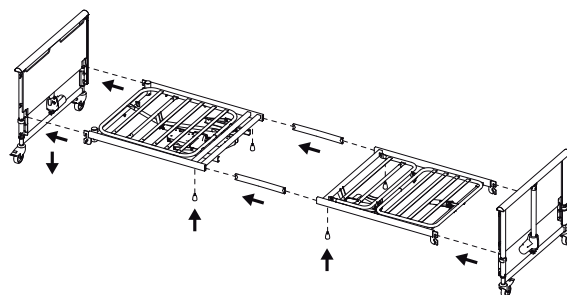

1. Plasser de to koplingsstykkene i den øvre halvdel av liggeflaten. Koplingsstykkene må monteres på en slik måte at den ene stikker lenger ut av siderøret enn den andre.
2. Skru de to tommeskruene løst til.
3. Skyv den nedre halvdel av liggeflaten inn på de to koplingsstykkene.
4. Stram til med to tommeskruer.
5. Stram også til de to tommeskruene i hodeenden av overrammen.
6. Vri de fire liggeflatebrakettene oppover.
7. Vri håndtaket på bendelen oppover.

8. Skyv braketten **A** på låseringen*, og vri låseringen på endegavlene til åpen stilling.

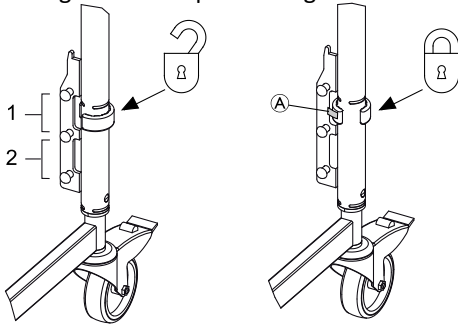


9. Lås liggeflaten fast til begge ender av sengen, og trykk den på plass.
 10. Kontroller at endegavlene er på samme nivå. Sengen kan stabiliseres både i høy posisjon (1) og i lav posisjon (2).
 11. Vri låseringen i låsestilling.

* Låseringene sørger for at liggeflaten ikke løftes opp fra endegavlene ved et uhell.

3.4.1 Feste etiketter


(Kun lav versjon)

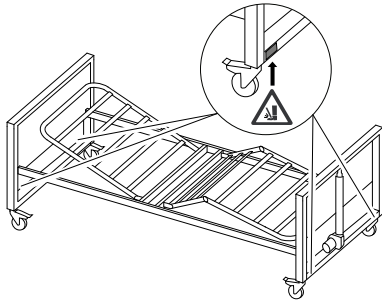

1. Plasser de fire fotklemme advarselsetikettene (leveres separat) på den nedre siden av endegavlene nær styrehjulene.

3.5 Kontrollboks

Kontrollboksen er låst fast til motoren på rygglenet.

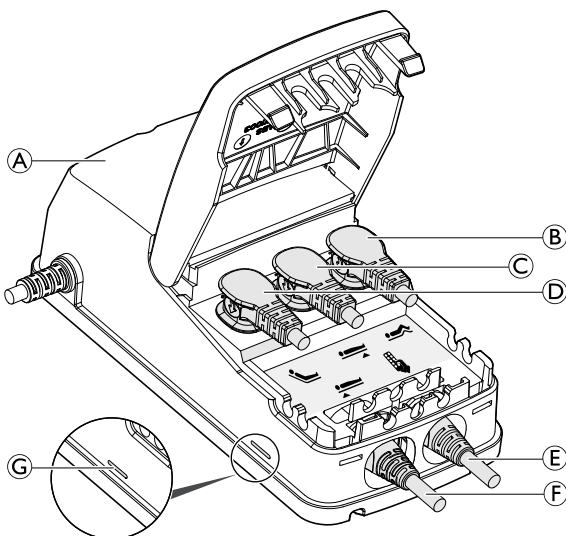

Kontrollboksen **A** leveres med en etikett med symboler som viser hvor motorstøpslene skal kobles til:

- Motor til lårdel **B**.

- Motor til endegavl, fotende **C**.
- Motor til hjertebrett **D**.
- Håndkontroll **E**.
- Motor til endegavl, hodeende **F**.

i Kontrollboksen har et **grønt** LED-lys **G** som indikerer at den er koblet til strømnettet. Når den er koblet til strømnettet, er det **grønne** LED-lyset **G** på.


3.6 Kabling

! LES DETTE!


- Ledningene må festes på en slik måte at de holdes unna gulvet og ikke blokkerer hjulene.

Følg anvisningene nedenfor for å hindre at ledningene skades når motorene aktiveres.

1. Sjekk etikettene på ledningene til Hi/Lo-motoren (spiralledningene), og koble ledningene til tilhørende motor ved endegavlene (hode- eller fotende).
2. Lukk låseklemmene på motorene, og sørg for at ledningene er godt festet.
3. Sett støpselet til strømledningen i stikkkontakten.
4. Hev sengen til høyeste posisjon.
5. Ta støpselet til strømledningen ut av stikkkontakten.
6. Før ledningen til lårdelmotoren gjennom åpningen i støtten for motoren til hjertebrett, og koble den deretter til motoren.

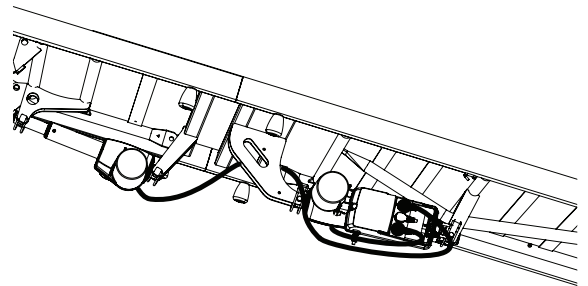


7. Før ledningen til hodeendens Hi/Lo-motor gjennom rammekrokene på sengesiden og enden av spiralledningen på kroken ved endegavlene.

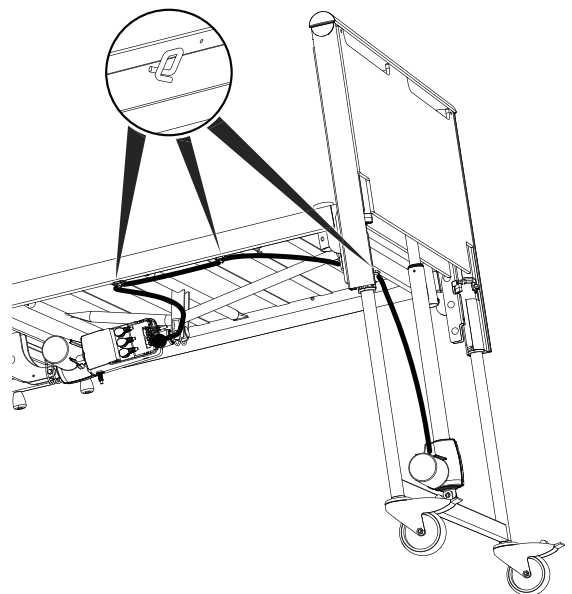


8. Koble ledningen til fotendens Hi/Lo-motor fra kontrollboksen, før den gjennom åpningen i støtten for motor til hjertebrett og koble den til igjen.

9. Plasser midten av spiralledningen til fotendens Hi/Lo-motor på kroken ved endegavl.

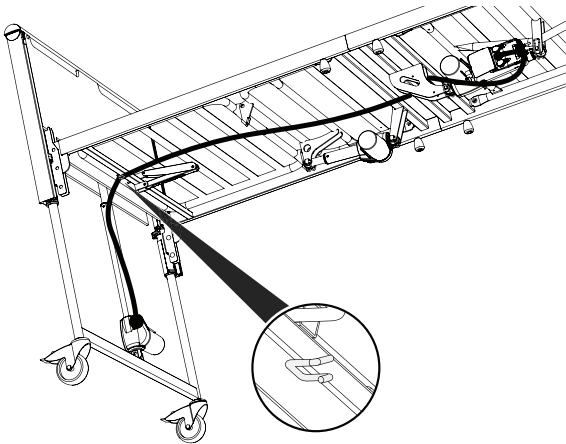

10. Før strømledningen gjennom rammekrokene på sengesiden, og sett støpselet i stikkkontakten.

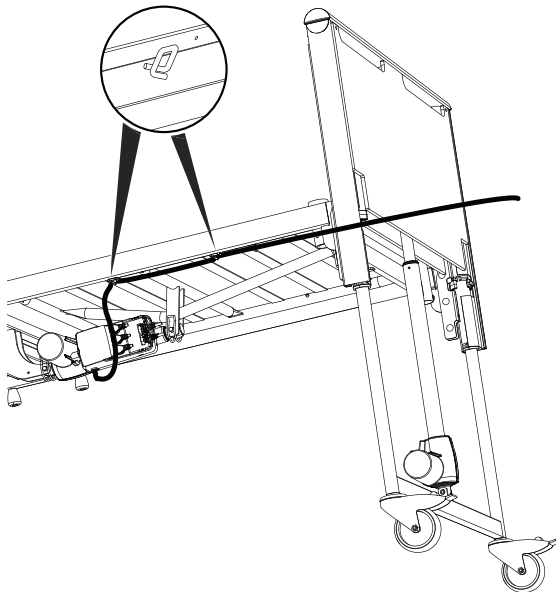

11. Før sengen tas i bruk må det kontrolleres at alle deler av sengen fungerer korrekt og at ingen motorledninger henger ned på gulvet eller blir klemt mellom bevegelige sengedeler.

3.7 Montering av sengegrinder



ADVARSEL!

Risiko for personskade

Det er fare for klemskader under monteringen og demonteringen av sengegrinden.

- Pass på fingrene dine.
- Følg anvisningene nøye.
- Etter hver montering bør du sjekke at alle festene er godt strammet til og at sengegrinden fungerer korrekt.

Avtagbare sengegrinder i 3/4 lengde



ADVARSEL!

Klemfare


Det finnes klem- eller kvelningsfare mellom liggeflate, sengegrind og endegavl.

– Ved bruk av avtagbare sengegrinder, skal det alltid sørges for at avstanden mellom endegavlens og øvre kant på sengegrindens håndtak er mindre enn 6 cm i hodeenden og mer enn 32 cm i fotenden av sengen.

3.7.1 Scala 2 sengegrind

Montere sengegrind

1.

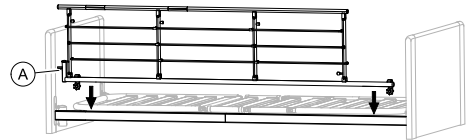


Plasser sengegrinden oppå overrammen med utløsermekanismen **A** mot hodeenden av sengen.



Gaflene på sengegrinden må monteres i samsvar med instruksjonen på sengegrinden.

2.

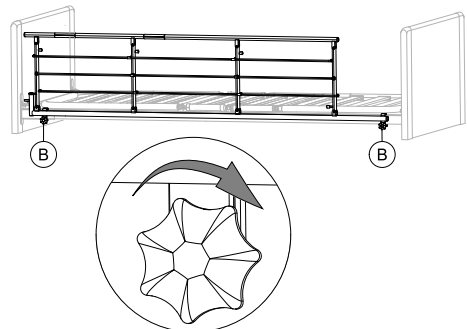

Stram til fingerskruer **B** for å feste sengegrinden til overrammen. Kontroller at sengegrinden er stabil og godt festet.

Demontere sengegrind

1. Løsne de to fingerskruene **B** og ta av sengegrinden.

3.7.2 Sengegrindene Britt V og Line





ADVARSEL!

Klem- og kvelningsfare

Hvis sengegrinden ikke er korrekt montert, eller den er skadet, kan brukeren komme i klem eller falle ut av sengen.

- Kontroller at alle glidesko sitter som de skal i endegavlens styrespor.
- Kontroller at alle sengegrindribber befinner seg over låsepinnen og er forsvarlig låst.
- Kontroller at stroppene mellom ribbene ikke er skadet eller løse.

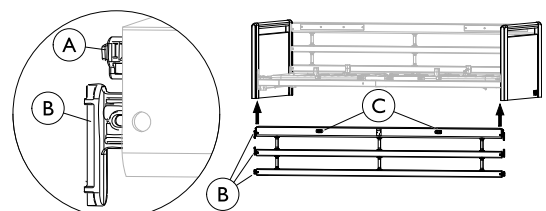

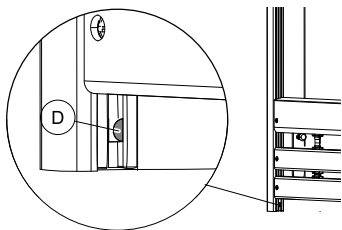

Montere

1. Løft den øvre ribben i én ende av sengegrinden. Utløserknappene © må vende oppover/utover.
2. Trykk på låsepinnen Ⓐ i enden av sengegrinden.
3. Før de tre glideskoene Ⓑ (i enden av sengegrindribbene) opp i styresporene i endegavlen helt til alle har passert låsepinnen Ⓓ.
4. Gjenta trinn 2 og 3 når du skal montere den andre enden av sengegrinden.

Demontere

1. Senk sengegrinden.
2. Løft den nedre ribben i én ende slik at du kan se låsepinnen Ⓓ, og trykk inn låsepinnen med en skrutrekker.
3. Senk alle tre ribber helt til de er ute av styresporene.
4. Gjenta trinn 2 til 3 når du skal ta av den andre enden av sengegrinden.

3.8 Demontere sengen

1. Fjern sengegrindene og løftebøylen.
2. Sett sengen i laveste posisjon og juster alle delene av liggeflaten til horisontal stilling.
3. Koble sengen fra strømmettet.
4. Koble fra ledningene til motorene ved endegavlene, og fjern dem fra rammekroken.
5. Koble fra ledningen til motoren til lår delen.
6. Fjern liggeflaten fra endegavlene.
7. Trekk fra hverandre hode- og fotenden av liggeflaten.

4 Betjene sengen

4.1 Generell sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL!

Skaderisiko for personer og materiell.

- Sengen må plasseres slik at høydejusteringen ikke hindres av for eksempel personløftere eller møbler.
- Sørg for at ingen kroppsdeler kommer i klem mellom faste deler (for eksempel sengegrinder, sengegavler osv.) og bevegelige deler.
- Barn skal ikke bruke håndkontrollen.



ADVARSEL!

Skaderisiko

- Hvis sengen benyttes av brukere som er forvirret, urolige eller har spasmer:
- lås håndkontrollens funksjoner dersom sengen er utstyrt med en låsbar håndkontroll, eller
 - påse at håndkontrollen er utenfor rekkevidde for brukeren

4.1.1 Lave høyder



FORSIKTIG!

Klemfare eller fare for å sette seg fast

- Avhengig av konfigurasjonen kan den ledige plassen mellom bevegelige og festede deler av sengen bli svært liten når sengen senkes.
- Kontroller at føttene dine ikke er i nærheten av eller under bevegelige deler når du senker sengen.
 - Kontroller at kablene er riktig rutet og ikke kan komme i klem når sengen senkes.



FORSIKTIG!

Skaderisiko

- Avhengig av konfigurasjonen, er minste arbeidshøyde for sengen svært lav. Bruk av feilaktig/feil holdning mens du arbeider ved lave arbeidshøyder kan føre til skader på pleieren.
- Vær oppmerksom på kroppsholdningen din når du hjelper brukeren.

4.1.2 Madrasstøtter



ADVARSEL!

Skaderisiko

- Hvis madrasstøttene ikke er riktig montert, kan madrassen gli sidelengs og brukeren kan falle ut av sengen.
- Bruk aldri sengen uten madrasstøtter.
 - Forsikre deg alltid om at madrasstøttene er riktig montert og vendt oppover.
 - Bruk bare originale madrasstøtter.

4.2 Håndkontroll

Håndkontrollen kan være utstyrt med tre eller fire knapper som styrer sengens elektriske funksjoner. Håndkontrollen kan også være utstyrt med en låsefunksjon.

Rygglenedel



1. Opp: trykk på venstre side av knappen (▲).
2. Ned: trykk på høyre side av knappen (▼).

Høydejustering



1. Opp: trykk på venstre side av knappen (▲).
2. Ned: trykk på høyre side av knappen (▼).

Lårdel



1. Opp: trykk på venstre side av knappen (▲).
2. Ned: trykk på høyre side av knappen (▼).

Vippefunksjon



FORSIKTIG!

Risiko for livstruende skade

- Å vinkle hodeenden nedover kan ha fatale følger for brukere som er følsomme for økt blodtrykk i den øvre delen av kroppen.
- Vinklingsfunksjonen skal kun betjenes av medisinsk personale.
 - Gjennomfør alltid en medisinsk evaluering før sengen vinkles slik at brukerens nedre ekstremiteter plasseres høyere enn hjertet.
 - Vinklingsfunksjonen er IKKE beregnet på å legge pasienter i Trendelenburg-stilling, og skal ikke brukes til medisinsk behandling.



1. Hodeende opp: trykk på venstre side av knappen (▲).
2. Fotende opp: trykk på høyre side av knappen (▼).


Hvis sengen bare er utstyrt med antivinklingsfunksjon, vil det ikke være mulig å vinkle sengen med fotenden oppover:



1. Hodeende opp: trykk på venstre side av knappen (▲).
2. Horisontal stilling: kjør sengen helt ned (▼).
Dette kan eventuelt utføres ved å trykke på høydejusteringsknappen som brukes til å kjøre sengen helt opp.

4.2.1 Låsefunksjon

Låsefunksjonen hindrer bruk av bestemte funksjonsknapper. Uansett hvor mange knapper håndkontrollen har, kan de alle låses enkeltvis.

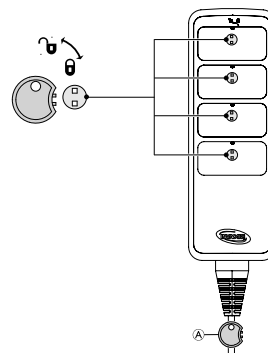

1. Sett inn nøkkel (A) i nøkkelhullet like over ønsket funksjon.
2. Hvis du vil låse, vrir du nøkkelen med klokken.
3. Hvis du vil låse opp, vrir du nøkkelen mot klokken.

4.3 Hjul og sentralbrems



FORSIKTIG! Klemfare

Alle bremsere betjenes med foten.
– Bruk ikke fingrer til å løsne bremsen.



FORSIKTIG! Fare for personskade


Dersom bremsene ikke er låste, kan brukeren falle når han/hun skal opp i eller ut av sengen.
– Lås alltid bremsene før brukeren skal opp i eller ut av sengen, eller når brukeren skal stelles.



Hjul kan lage merker på forskjellige typer gulvbelegg – for eksempel på ubehandlede gulv og gulv med dårlig overflatebehandling. *Invacare*® anbefaler å plassere en passende form for beskyttelse mellom hjulene og gulvet for å hindre merker.


4.3.1 Hjulbrems

Låse bremsen

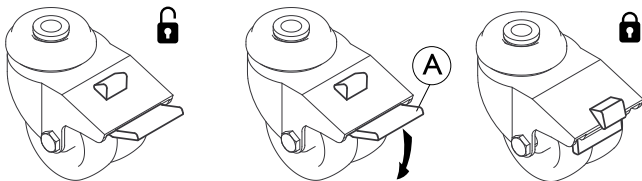

Trå på den ytre pedalen (A).

Låse opp bremsen

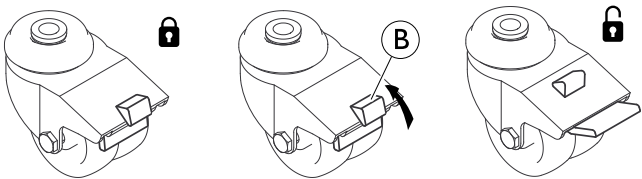

Skyv frigjøringsknappen (B) oppover.

4.4 Bruk av sengegrind



ADVARSEL! Klem- og kvelningsfare

Det finnes klem- eller kvelningsfare mellom liggeflate, sengegrind og endegavl.
– Pass alltid på at sengegrinden er riktig festet og at festene er godt strammet til.



ADVARSEL! Risiko for å falle

Hvis det har blitt besluttet at brukeren trenger sengegrind:
– Ikke forlat brukeren uten tilsyn når sengegrinden er nede.
– Sørg for at sengegrinden er i høyeste posisjon og låst fast på riktig måte når brukeren er uten tilsyn.



FORSIKTIG! Skaderisiko

Hvis sengegrinden ikke er låst på riktig måte, kan den falle ned.
– Trekk/skyv den øverste ribben på sengegrinden for å sikre at låsesystemet er riktig aktivert.



FORSIKTIG! Skaderisiko

Det er fare for klemskader ved betjening av sengegrinden.
– Pass på fingrene dine og kroppsdelen til pasienten.
– Aldri tving eller slipp sengegrinden under bruk.


4.4.1 Bruk av Scala 2 sengegrind




LES DETTE!

– Når du skal manøvrere sengegrinden, må du bare plassere hendene i de områdene som er merket med gripeetiketten.

1.

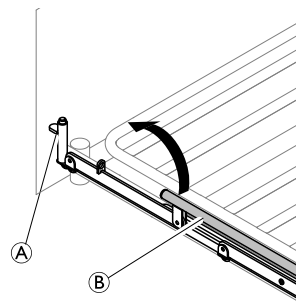


2.

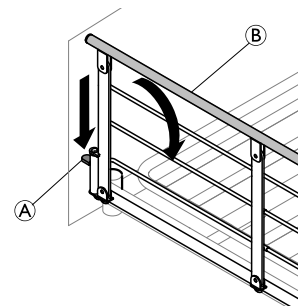

1. **Opp:** Løft og trekk den øverste ribben (B) på sengegrinden mot enden med låsemekanismen (frigjøringsknappen) (A). Sørg for at den er låst på plass.
2. **Ned:** Trykk på frigjøringsknapp (A) og skyv den øverste ribben (B) på sengegrinden bort fra låsemekanismen.

4.4.2 Sengegrindene Line og Britt V

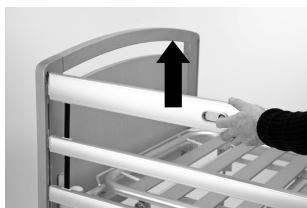

Lås / øverste posisjon

Dra opp det øverste ribben på sengegrinden til låsepinnen går i lås med et hørbart klikk.



Frigjøre

Løft den øverste ribben på sengegrinden, og trykk sammen de to låseringene.



Ned / laveste posisjon

Senk sengegrinden.

Bruke høydeforlenger for sengegrind

Sengegrindene Line og Britt V kan suppleres med en høydeforlenger. En høydeforlenger for sengegrinder øker tillatt madrassykkelse med 15 cm.




ADVARSEL!

Risiko for personskade eller død


En høydeforlenger som er montert feil på sengegrinden, kan falle av. Det er større risiko for at brukeren skal falle ut av sengen.

- Pass på at høydeforlengeren for sengegrinden er korrekt festet til sengegrinden. Se i bruksanvisningen som følger med høydeforlengeren for sengegrinder.
- Pass på at det brukes riktig høydeforlenger til sengegrinden (formen må passe til formen på sengegrinden). En etikett på høydeforlengeren angir hvilken sengegrind den kan brukes sammen med. Se bildet nedenfor.

Høydeforlenger for LINE sengegrind:

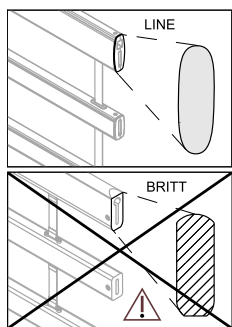

Høydeforlenger for BRITT V sengegrind:

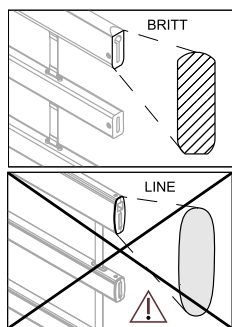

4.5 Løftebøyle



ADVARSEL!

Fare for personskade

Hvis håndtaket brukes mens løftebøylen vender bort fra sengen, kan sengen velte.

- Plasser alltid løftebøylen på en slik måte at håndtaket henger over sengen.
- Overskrid ikke løftebøylens maksimale belastning: 80 kg.

4.5.1 Plasser løftebøylen

Løftebøylen kan plasseres enten på venstre eller høyre side av hodegavlen.

1. Sett løftebøylen inn i løftebøylørøret, og fest den med fingerskruen.




Det er ikke nødvendig å stramme fingerskruen, i tilfelle du vil at løftebøylen skal svinge ut til siden av sengen.


4.5.2 Justering av håndtakshøyde

Håndtakshøyden bør alltid tilpasses behovene til brukeren.

1.



2.



1. Hold snoren ut mens du skyver plastsnorlåsen (A) oppover eller nedover til håndtaket når den foretrukne høyden.
2. Lås håndtaket ved å trykke snoren tilbake i lås (A), og dra håndtaket nedover.




LES DETTE!

Etter justering av håndtakshøyde:

- Sjekk at de to snorene over snorlåsen er parallelle og inne i snorlåsen.
- Pass på at ledningen er riktig låst ved å dra hardt i håndtaket.

4.6 Justere benseksjonen

Benseksjonen justeres ved å løfte madrasshåndtaket:

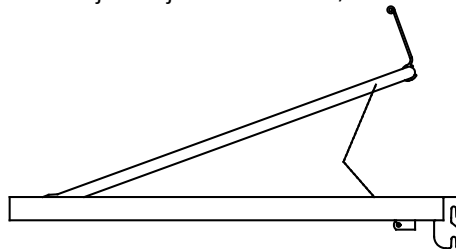

1. **Opp:** Løft madrasshåndtaket på benseksjonen.
2. **Ned:** Løft madrasshåndtaket på benseksjonen rett opp, og senk deretter benseksjonen.

4.7 Nødposisjoner

Hvis det oppstår en medisinsk nødsituasjon, kan det være nødvendig å sette alle eller enkelte deler av liggeflaten i flat posisjon – f.eks. flate ut ryggdelen for hjerte-lunge-redning (HLR).

Når du skal sette en liggeflatedel i flat posisjon,

- bruker du den tilsvarende funksjonen på håndkontrollen
- ELLER
- i tilfelle strømbrudd eller ved akutt behov for handling, bruker du den manuelle nødsenkning-funksjonen og senker liggeflatedelen.

Se 4.7.1 Nødsenkning av en liggeflatedel, side 17.

4.7.1 Nødsenkning av en liggeflatedel

Ved strøm- eller motorsvikt, kan det være nødvendig med nødsenkning av rygg-, lår- eller bendel. Nødsenkning av høydejusteringen er IKKE mulig.



FORSIKTIG! **Skaderisiko**


- Minst to personer er nødvendig for nødsenkning av en liggeflatedel.
- Når du frigjør en liggeflatedel, kan den senkes raskt. Ikke strekk deg under liggeflaten mens du senker den.



LES DETTE!

- Før nødsenkning av liggeflaten, skal støpselet tas ut av stikkontakten.

1. Begge personer holder madrassen delen.
2. Én av dem lokaliserer motoren det gjelder, og trekker ut sikkerhetssplinten.

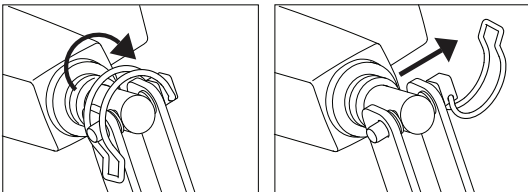


3. Begge personen senker liggeflaten sakte, til den er helt nede.

4.8 Liggeflateforlenger



For brukere som er høyere enn to meter, anbefales bruk av en liggeflateforlenger.

Montere liggeflateforlenger

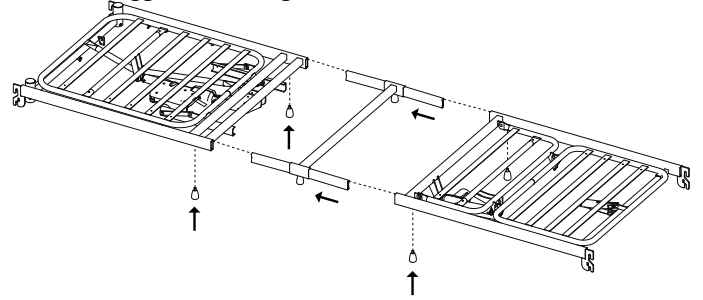

1. Demonter sengen og fjern koplingsstykkene.
2. Monter liggeflateforlengeren mellom begge deler av liggeflaten, og sett sammen sengen igjen.

4.9 Transport og oppbevaring

Sengen kan transporteres eller oppbevares i montert eller demontert tilstand.


Se 3.8 Demontere sengen, side 13 for detaljerte instruksjoner om hvordan du demonterer sengen.

Slik transporterer eller oppbevarer du sengen når den er montert:

1. Koble strømledningen fra stikkontakten.
2. Kveil sammen strømledningen, og sørg for at den ikke havner på gulvet og blir skadet under transport eller lagring.

5 Ekstraustyr

5.1 Liste over tilgjengelig tilbehør

 På grunn av regionale forskjeller må du se ditt lokale Invacare-nettsted eller den lokale Invacare-katalogen for detaljer om tilgjengelig tilbehør. Alternativt kan du kontakte Invacare-leverandøren.

- Sengegrind
 - Scala Basic 2
3/4 lengde nedfellbar sengegrind i metall (168 cm x 40 cm), montert på siderøret. Frigjøringsknapp i hodedelen
 - Scala Basic Plus 2
3/4 lengde nedfellbar sengegrind i metall (168 cm x 40 cm), montert på siderøret. Frigjøringsknapp i hodedelen
 - Scala Medium 2
3/4 lengde nedfellbar sengegrind i metall (165 cm x 46 cm), montert på siderøret. Frigjøringsknapp i hodedelen
 - Scala Decubi 2
3/4 lengde nedfellbar sengegrind i metall (168 cm x 54 cm), montert på siderøret. Frigjøringsknapp i hodedelen
 - Britt V
Full lengde nedfellbar sengegrind i tre (205 cm x 40 cm), montert på styresporet på endegavlen. Frigjøringsknapper i midten
 - Line standard
Full lengde nedfellbar sengegrind i aluminium (206 cm x 40 cm), montert på styresporet på endegavlen. Frigjøringsknapper i midten
 - Linje uttrekkbar
Full lengde nedfellbar sengegrind med teleskopforlenger i aluminium (206-226 cm x 40 cm), montert på styresporet på endegavlen. Frigjøringsknapper i midten
 - Høydeforlenger til Britt V og Line sengegrinder
 - Trekk for sengegrinder – tekstiltrekk for de ulike sengegrindene (nett eller polstret)
- Liggeflateforlenger (senter) –10 eller 20 cm
- Liggeflateforlenger (fotende) – 10 cm
- Løftebøyle
- Festede støtte/vendehåndtak – 25 cm x 30 cm, 25 cm x 80 cm, 40 cm x 30 cm, 40 cm x 50 cm eller 40 cm x 80 cm
- Svingende støtte-/vendehåndtak
- Sit-up-støtte
- Stand-up støtte
- Håndkontroller
 - med rygg-, lår- og høydejustering
 - med rygg-, lår- og høydejustering, vippe- og antivippefunksjon
 - med rygg-, lår- og høydejustering og antivippefunksjon
- Soft Tilt – Et system for å flytte på pasienten, som er montert på madrassplattformen.

- Transportbeslag




LES DETTE!


- Bruk bare originalt tilbehør og reservedeler. Resevedelslister og ekstra bruksanvisninger kan bestilles fra Invacare.

5.2 Transportbraketter


1.

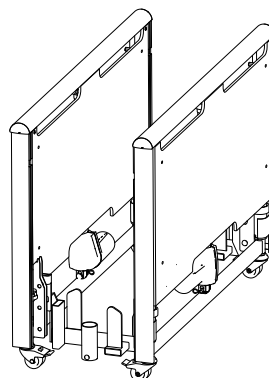


2.

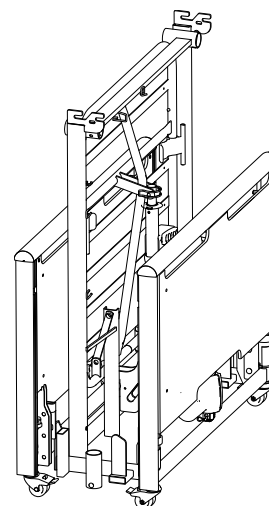

3.

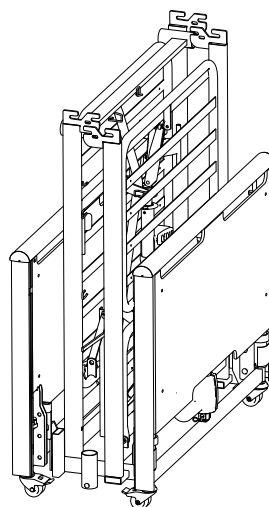

4.

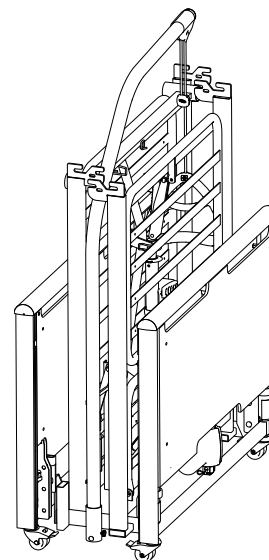

1. Plasser begge endegavler på brakettene.
2. Sett på liggeflatens hodedel.
3. Sett på liggeflatens bendel.
4. Sett løftebøylene på brakettene.

6 Vedlikehold

6.1 Generell vedlikeholdsinformasjon



FORSIKTIG!

Personskaderisiko eller risiko for skade på utstyr

- Ikke utfør noen service- eller vedlikeholdsprosedyrer mens produktet er i bruk.

Følg vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i denne håndboken for å sikre at produktet kan holdes i kontinuerlig drift.

6.2 Daglige inspeksjoner



ADVARSEL!

Personskaderisiko eller risiko for skade på utstyr

- Skadde eller slitte deler kan påvirke produktsikkerheten.
- Produktet må kontrolleres hver gang det brukes.
 - Ikke bruk produktet hvis det oppdages skader eller du er i tvil vedrørende sikkerheten til noen av produktets deler. Kontakt Invacare-leverandøren umiddelbart, og sørg for at produktet ikke brukes før reparasjoner er utført.

Sjekkliste for daglig inspeksjon

- Kontroller sengen visuelt. Kontroller alle deler med tanke på utvendig skade eller slitasje.
- Kontroller alle monteringsdeler, festepunkter, belastede deler og alle bevegelige ledd for tegn på slitasje, sprekker, formendringer og forringelse.
- Kontroller håndkontrollen og alle løftemotorene for problemfri drift.

6.3 Generell serviceinformasjon



LES DETTE!

- Liggeflaten må støttes for å unngå utilsiktet senking under servicekontroller.
- Bare personell som har fått nødvendige instruksjoner og opplæring, kan utføre service og vedlikehold av sengen.
- Når sengen har blitt overhaldt eller det har blitt foretatt endringer i sengens funksjoner, må det utføres service i henhold til sjekklisten.

I land hvor Invacare har sine egne salgsorganisasjoner, kan du inngå en serviceavtale. I visse land tilbyr Invacare opplæring i service og vedlikehold av senger. Reservelister og ekstra bruksanvisninger er tilgjengelige fra Invacare.

Før bruk

- Kontroller at alle manuelle og elektriske deler fungerer som de skal, og er sikret.

Etter tre måneder

- Kontroller at alle manuelle og elektriske deler fungerer, og stram til bolter, skruer, muttere osv.

Hvert år

- Vi anbefaler at det utføres en sikkerhetstest som omfatter løftemotorenes ytelse og mekaniske tilstand.

Annethvert år

- Vi anbefaler på det sterkeste service i henhold til sjekklisten nedenfor etter to år med normal bruk og deretter annethvert år.



Service på løftemotorer, håndkontroll og kontrollenhet finner sted ved utskifting av defekte deler.

6.3.1 Sjekkliste for vedlikehold

Sjekkpunkter

- Visuell inspeksjon av alle sengens deler (ikke deformert)
- Låseringer, låsepinner og plastfestering – låste og i god stand.
- Skruer – strammet.
- Sveisesømmer – hele (ingen slitasje eller brudd)
- Hjul (ruller jevnt og fritt)
- Hjulinnfestinger – strammet til.
- Hjulbremsere – går ordentlig i lås.
- Alle motorer – kjører uten feil (med vanlig hastighet og lavt støynivå).
- Ledninger – korrekt lagt og uten skader.
- Elektriske støpsler – uten skader.
- Sengenrindens låse- og bevegelsessystem – låses som de skal, og glir lett.
- Ekstraustyr – korrekt montert og virker som det skal.
- Overflateskader – reparert.
- Lekkasje av smørefett – se etter fett.



FORSIKTIG!

Skaderisiko for personer eller materiell

Lekkasje av smørefett kan forårsake fall eller brann.

- Kontakt tjenesteleverandøren hvis det oppdages lekkasje av smørefett eller andre avleiringer.

6.4 Inspeksjon etter flytting – klargjøre for ny bruker



LES DETTE!

- Når sengen har blitt flyttet: S engen må kontrolleres grundig før den gis til en ny bruker.
- Inspeksjonen må utføres av opplært personell.
 - Se vedlikeholdsplanen for informasjon om regelmessig vedlikehold.

6.4.1 Sjekkliste – etter flytting

Sjekkpunkter

- Kontroller at koplingsstykkene som kopler sammen de to liggeflatehalvdelenene, er satt helt inn og er låst.
- Kontroller at liggeflaten er korrekt montert på endegavlene, og at låseringen er i låst stilling.
- Kontroller motorlåsene (at låsepinnene er korrekt montert).
- Kontroller den elektroniske kablingen til motorene (at ledningene ikke ligger i klem).
- Kontroller at motorhusene er intakte (ingen sprekker som gir rom for væskeinntrengning).
- Kontroller at låsekammen er riktig montert over kontaktene i kontrollboksen.
- Kontroller liggeflatens deler ved å aktivere alle bevegelsesfunksjoner ved hjelp av håndkontrollen.
- Kontroller at bremsene virker.

- Kontroller låsefunksjonen til sengegrindene.
- Kontroller at alle sengeribber er intakte og ikke har løsnet.

6.5 Rengjøring og desinfisering

6.5.1 Generell sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG!

Risiko for kontaminering

- Ta dine egne forholdsregler og bruk passende verneutstyr.



FORSIKTIG!

Fare for elektrisk støt og skade på produktet

- Slå av enheten og koble den fra nettet om aktuelt.
- Vurder verneklassen angående vanninntrenging når du rengjør elektroniske komponenter.
- Pass på at det ikke sprutes vann på støpselet eller stikkkontakten.
- Ikke ta i stikkkontakten med våte hender.



LES DETTE!

Feil væsker eller metoder kan skade eller ødelegge produktet.

- Alle rengjørings- og desinfeksjonsmidler må være av god kvalitet og kompatible med hverandre. I tillegg må de beskytte materialene de skal rengjøre.
- Bruk aldri etsende væsker (baser, syrer osv.) eller slipende rengjøringsmidler. Vi anbefaler et vanlig rengjøringsmiddel for husholdning som for eksempel oppvaskmiddel hvis ikke noe annet er spesifisert i rengjøringsanvisningene.
- Bruk aldri et løsemiddel (cellulosefjernere, aceton etc.) som forandrer plastens struktur eller får etikettene til å løsne.
- Sørg alltid for at produktet er helt tørket før det tas i bruk igjen.



For rengjøring og desinfeksjon i kliniske omgivelser eller ved langvarig pleie, gjelder institusjonelle retningslinjer for hygiene.

6.5.2 Rengjøringshyppighet



LES DETTE!

Regelmessig rengjøring og desinfeksjon bidrar til problemfri bruk, lenger levetid og forhindrer kontaminering.

- Rengjør og desinfiser produktet
- regelmessig mens det er i bruk
 - før og etter enhver serviceprosedyre
 - når det har vært i kontakt med enhver type kroppsvæske
 - før det brukes på en ny bruker

6.5.3 Rengjøring for hånd

Alle deler (unntatt avtakbare tekstiler)

- Rengjøringsmiddel: Vi anbefaler at du bruker et mildt vaskemiddel med nøytral eller nær nøytral pH (5–9).



Kommersielt tilgjengelige forbrukerprodukter som oppvaskmiddel eller universalrengjøringsmidler kan benyttes. Les instruksjonene på etiketten til rengjøringsmiddelet og bruk det ved den angitte konsentrasjonen.

- Maks. vanntemperatur: 40 °C
1. Tørk overflater grundig med en myk klut lett fuktet med rengjøringsmiddel helt til alt synlig smuss er fjernet.
 2. Fjern alle rester av rengjøringsmiddel med en ren, fuktig klut.
 3. Tørk med en ren, myk klut.

Avtakbare tekstiler (inkluderer polstring og madrasser)

- Se påsatt etikett på hvert produkt.

6.5.4 Instruksjoner for desinfisering

I hjemmet

- Desinfiseringsmiddel: Vi anbefaler bruk av et alkoholbasert overflatedesinfeksjonsmiddel (med 70–90 % alkohol).



Les instruksjonene på etiketten til desinfeksjonsmiddelet. Den gir informasjon om aktivitetsspekteret (bakterier, sopp og/eller virus), materialkompatibilitet og riktig eksponeringstid.

1. Sørg for at overflatene rengjøres før desinfisering.
2. Fukt en myk klut og tørk – desinfiser alle tilgjengelige overflater, og hold dem fuktet for eksponeringstiden som er angitt på etiketten til desinfeksjonsmiddelet.
3. La produktet lufttørke.

På institusjoner

Følg de interne desinfiseringsprosedyrer, og bruk bare de desinfeksjonsmidlene og metodene som er angitt der.

6.6 Smøring

Vi anbefaler at sengen smøres i samsvar med følgende instruksjoner etter service og rengjøring, eller når det er nødvendig for å redusere friksjonen.

Del av seng	Smøremetode
Rotasjonspunkter på liggeflaten	Olje (aseptisk)
Motorfestepunkter på liggeflaten	Olje (aseptisk)
Motorlagre og spenningsstenger	Olje (aseptisk)



Glidesystemet for sidegrinder i tre må ikke smøres med olje – da vil treribbene bevege seg tregt.

Kontakt Invacare leverandør for å bestille riktig olje.

7 Etter bruk

7.1 Avfallshåndtering

Vi ber deg vise miljøansvar og levere dette produktet til en lokal gjenvinningsstasjon ved endt brukstid.

Demonter produktet og dets komponenter, slik at de ulike materialene kan sorteres og gjenvinnes hver for seg.

Kassering og gjenvinning av brukte produkter og emballasje må overholde lovene og forskriftene for avfallshåndtering i hvert land. Ytterligere informasjon får du hos det lokale renovasjonsselskapet.

7.2 Overhaling

Dette produktet er egnet for gjenbruk. Utfør følgende punkter når produktet skal overhales og overføres til en ny bruker:

- Kontroll
- Rengjøring og desinfisering


For detaljert informasjon, se *6 Vedlikehold, side 19*.

Sørg for at bruksanvisningen overleveres sammen med produktet.

Hvis det oppdages skade eller feil, må du ikke bruke produktet på nytt.

8 Feilsøking

8.1 Feilsøking av elektrisk system

Symptom	Mulig årsak	Løsning
Strømindikatoren lyser ikke	Strømledningen er ikke tilkoblet	Koble til strømledningen
	Sikringen i kontrollenheten er gått	* Skift ut kontrollenheten
	Kontrollenheten er defekt	* Skift ut kontrollenheten
Strømindikatoren lyser, men motoren går ikke Releet i kontrollenheten lager en klikkende lyd	Kontakten til motoren er ikke satt helt inn i kontrollenheten	Sett motorstøpselet ordentlig inn i kontrollenheten
	Motoren er defekt	* Skift ut motoren
	Motorkabelen er skadet	* Skift ut kabelen
	Kontrollenheten er defekt	* Skift ut kontrollenheten
Strømindikatoren lyser, men motoren går ikke Det høres ingen lyd fra releet i kontrollenheten	Kontrollenheten er defekt	* Skift ut kontrollenheten
	Håndkontrollen er defekt	* Skift ut håndkontrollen
Kontrollenheten er i orden, bortsett fra én retning på én kanal	Kontrollenheten er defekt	* Skift ut kontrollenheten
	Håndkontrollen er defekt	* Skift ut håndkontrollen
Motoren går, men stempelstangen beveger seg ikke	Motoren er skadet	* Skift ut motoren
Motoren kan ikke løfte full belastning.		
Det høres motorlyd, men stempelstangen beveger seg ikke.		
Stempelstangen beveger seg innover og ikke utover		
* Kun personell som har fått nødvendige instruksjoner og opplæring, skal utføre service på og vedlikehold av sengen.		
 ADVARSEL! Risiko for skade på personer og materiell. – Sengen må være koblet fra strømmettet før du åpner eller reparerer elektriske komponenter.		

9 Tekniske Data


9.1 Materialer

Madrassplattform	Stål (pulverbelagt)
Sengegavler	Stål (pulverbelagt) og MDF
Sengegrinder	Stål (pulverbelagt), tre eller aluminium
Løftebøyle	Stål (pulverbelagt), PP og POM
Løftemotorhus, håndkontroll, kontrollboks, styrehjul, andre plastdeler	Materialer i henhold til merking (PA, PP, PE, ABS)
Skruer og muttere	Stål (sinksbelagt)

9.2 Dimensjoner

Alle mål er angitt i cm. Alle vinkler er angitt i grader. Alle mål og vinkler er angitt uten slingringsmonn.


Invacare®forbeholder seg retten til å endre de oppgitte målene og vinklene.

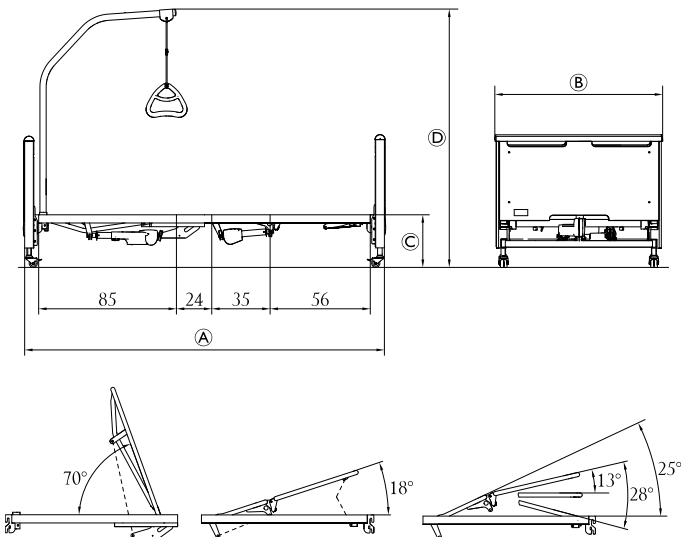

	Etude Plus lav		Etude Plus	
	Lav	Høy	Lav	Høy
Ⓐ	219	219	219	219
Ⓑ	102	102	102	102
Ⓒ	20–60	27–67	33–73	40–80
Ⓓ	138–178	145–185	158–198	165–205

Vinkelen mellom nedre del av sengen (under bena) og horisontalplanet kan justeres fra 0° til 15°.

Seng med vippefunksjon



9.3 Vekt

	Maks. pasientvekt (gitt at vekten av madrassen og tilbehøret ikke overstiger 35 kg)	165 kg
	Maks. arbeidsbelastning (pasient + tilbehør)	200 kg

Etude Plus standardseng, komplett, uten tilbehør	76,5 kg
Etude Plus med automatisk trykkavlastning, komplett, uten tilbehør	84,35 kg
Etude Plus endegavl med ekstra plate – 1 stk.	19,0 kg
Etude Plus endegavl uten ekstra plate – 1 stk.	17,0 kg
Liggeflate, standard, hodeende	22,5 kg
Liggeflate med automatisk trykkavlastning, hodeende	26,0 kg
Liggeflate med automatisk trykkavlastning, hodeende, uten løftemotor og kontrollboks	21,5 kg
Liggeflate, hodeende	17,0 kg
Liggeflate, fotende, elektrisk øvre bendel	21,35 kg
Liggeflateforlenger (10 cm)	3,5 kg
Liggeflateforlenger (20 cm)	5,5 kg
Scala Basic 2 sengegrind – 1 stk.	7,4 kg
Scala Basic Plus 2 sengegrind – 1 stk.	7,4 kg
Scala Medium 2 sengegrind – 1 stk.	8,9 kg
Scala Decubi 2 sengegrind – 1 stk.	10,3 kg
Britt V sengegrind – 1 side	7,7 kg
Line sengegrind – 1 side	4,5 kg
Line sengegrind, forlengbar – 1 side	6,5 kg
Løftebøyle	6,0 kg

9.4 Madrass

Sidegrind:	Madrassmål (i cm):			
	Min. høyde	Maks. høyde	Min. bredde	Min. lengde
Scala Basic 2	10	17	85 – 90	200
Scala Basic Plus 2	10	17	85 – 90	200
Scala Medium 2	10	22	85 – 90	200
Scala Decubi 2	23	31	85 – 90	200
Line*, Madrassstøtteplattform i lav posisjon	11	22	88 – 90	200
Line*, Madrassstøtteplattform i høy posisjon	5	15	88 – 90	200
Britt V, Madrassstøtteplattform i lav posisjon	11	22	85 – 90	200
Britt V, Madrassstøtteplattform i høy posisjon	5	15	85 – 90	200

* både standard og forlengbare Line sidegrinder.

Min. tetthet: 38 kg/m³

9.5 Miljøbetingelser

	Oppbevaring og transport	Bruk
Temperatur	-10 °C til +50 °C	+5 °C til +40 °C
Relativ luftfuktighet	20 % til 80 % – ikke-kondenserende	
Atmosfærisk trykk	700 hPa til 1060 hPa	


 Produktet må nå brukstemperatur før det tas i bruk:

- Oppvarming fra laveste oppbevaringstemperatur kan ta opptil 24 timer.
- Nedkjøling fra høyeste oppbevaringstemperatur kan ta opptil 24 timer.

9.6 Elektrisk system

Spenningsforsyning	UIN = 230 volt, AC, 50/60 Hz (AC = vekselstrøm)
Maksimal inngangsstrøm	lin maks. = 1,5 A
Intermitterende (periodisk motordrift)	Int = 10 % maks. 2 min/18 min

Beskyttelsesgrad	IPX6 eller IPX4 (avhengig av utstyrets konfigurasjon) Når sengen er utstyrt med elektrisk benstøtte, er den beskyttet i henhold til IPX4. IPX6 – Det elektriske systemet er beskyttet mot kraftige vannstråler som spyles fra alle retninger. IPX4 – Det elektriske systemet er beskyttet mot vannsprut mot komponentene fra alle retninger.
Isolasjonsklasse	Klasse II-utstyr
Type B-kontakt del	Kontakt del i samsvar med de angitte kravene til beskyttelse mot elektrisk støt i henhold til IEC60601-1.
Lydnivå	45 til 50 dB (A)

 Sengen har ikke isolator (hovedbryter). Hvis sengen skal kobles fra strøm, skal det skje ved at støpselet kobles fra stikkontakten.

10 Elektromagnetisk kompatibilitet

10.1 Generell EMC-informasjon

Medisinsk elektrisk utstyr skal installeres og brukes i samsvar med EMC-opplysningene i denne bruksanvisningen.

Dette produktet er testet og overholder EMC-begrensninger som spesifisert i IEC/EN 60601-1-2 for klasse B-utstyr.

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke funksjonen til dette produktet.

Andre apparater kan oppleve interferens selv ved de svake nivåene av elektromagnetisk stråling som er tillatt i samsvar med standarden nevnt ovenfor. For å påvise om utslippet fra dette produktet forårsaker forstyrrelsen, kjør og slå av produktet. Hvis forstyrrelsen ved den andre enheten opphører, er det dette produktet som forårsaker forstyrrelsen. I slike sjeldne tilfeller kan du redusere eller korrigere interferens på følgende måte:

- Snu eller flytt apparatene, eller øk avstanden mellom dem.

10.2 Elektromagnetisk utslipp

Veiledning og produsentens erklæring

Dette produktet er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø som angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av dette produktet må sikre at systemet brukes i en slik omgivelse.


Strålingstest	Samsvar	Elektromagnetisk miljø – rettledning
RF-stråling CISPR 11	Gruppe I	Dette produktet bruker RF-energi bare for sin interne funksjon. RF-utstrålingen er derfor svært lav, og det er usannsynlig at den vil forårsake interferens i elektronisk utstyr i nærheten.
RF-stråling CISPR 11	Klasse B	Dette produktet er egnet til bruk i alle sammenhenger, inkludert private husholdninger og de som er direkte knyttet til det offentlige lavspenningsnett som leverer til bygninger som brukes til husholdsbruk.
Harmonisk utstråling IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spennings-svingninger/ flimmerstråling IEC 61000-3-3	Overholder	

10.3 Elektromagnetisk immunitet

Veiledning og produsentens erklæring

Dette produktet er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø som angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av dette produktet må sikre at systemet brukes i en slik omgivelse.

Immunitetstest	Test / samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø - veiledning
Elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft	Gulvet bør være av tre, betong eller belagt med keramiske fliser. Hvis gulvet er dekket med syntetiske materialer, bør den relative luftfuktigheten være på minst 30 %.
Elektrostatisk rask transient / puls IEC 61000-4-4	± 2 kV for strømforsyningslinjer; 100 kHz repetisjonsfrekvens ± 1 kV for inngangs/utgangslinjer; 100 kHz repetisjonsfrekvens	Kvaliteten på nettstrømmen skal tilsvare et typisk bedrifts- eller sykehusmiljø.
Overspenning IEC 61000-4-5	± 1 kV linje til linje ± 2 kV linje til jord	Kvaliteten på nettstrømmen skal tilsvare et typisk bedrifts- eller sykehusmiljø.

Immunitetstest	Test / samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø - veiledning
Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvingninger i strømforsyningens inngangslinjer IEC 61000-4-11	< 0 % U_T i 0,5 syklus i trinn på 45 ° 0 % U_T i 1 syklus 70 % U_T i 25 / 30 sykluser < 5 % U_T i 250 / 300 sykluser	Kvaliteten på nettstrømmen skal tilsvare et typisk bedrifts- eller sykehusmiljø. Dersom brukeren av dette produktet krever uavbrutt drift ved strømbrudd, anbefales det at produktet får strøm fra en avbruddsfri strømkilde eller et batteri. U_T er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået.
Strømfrekvensens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	30 A/m	Strømfrekvensens magnetfelt bør tilsvare det typiske nivået for en vanlig plassering i et bedrifts- eller sykehusmiljø.
Ledet RF IEC 61000-4-6	3 V 150 kHz til 80 Mhz 6 V i ISM- og amatørradiobånd	Det er ikke mulig å teoretisk forutsi feltstyrke fra faste sendere, f.eks. basestasjoner for radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-sendinger nøyaktig. For å bestemme det elektromagnetiske miljøet som skyldes faste RF-sendere, bør det vurderes å gjennomføre en elektromagnetisk undersøkelse på stedet. Hvis den målte feltstyrken på stedet der dette produktet skal brukes overskrider det anvendelige RF-samsvarsnivået ovenfor, må dette produktet observeres for å bekrefte at det fungerer som det skal. Dersom det observeres unormal ytelse, kan det være påkrevd med ytterligere tiltak, som å snu eller flytte på dette produktet. Det kan oppstå interferens i nærheten av utstyr som er merket med følgende symbol: 
Utstrålt RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 Mhz til 2,7 GHz 385 MHz - 5785 MHz testspesifikasjoner for immunitet for trådløst RF-kommunikasjonsutstyr, se tabell 9 i IEC 60601-1-2:2014	Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere enn 30 cm fra noen del av dette produktet (inkludert kabler).




Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorbering og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.

10.3.1 Testspesifikasjoner for immunitet for trådløst RF-kommunikasjonsutstyr

IEC 60601-1-2:2014 – Tabell 9

Testfrekvens (MHz)	Bånd ^{a)} (MHz)	Service ^{a)}	Modulasjon ^{b)}	Maksimal effekt (W)	Avstand (m)	Immunitets-testnivå (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Pulsmodulasjon ^{b)} 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ^{c)} ± 5 kHz avvik 1 kHz sinus	2	0,3	28
710 745 788	704 - 787	LTE-bånd 13, 17	Pulsmodulasjon ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9
810 870 930	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE-bånd 5	Pulsmodulasjon ^{b)} 18 Hz	2	0,3	28

Testfrekvens (MHz)	Bånd ^{a)} (MHz)	Service ^{a)}	Modulasjon ^{b)}	Maksimal effekt (W)	Avstand (m)	Immunitets-testnivå (V/m)
1720 1845 1970	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT LTE-bånd 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulsmodulasjon ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE-bånd 7	Pulsmodulasjon ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28
5240 5500 5785	5100 - 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulsmodulasjon ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9

 Hvis det er nødvendig å oppnå immunitetstestnivået, kan avstanden mellom senderantennen og det medisinske elektriske utstyret eller systemet reduseres til 1 m. Testavstanden på 1 m er tillatt via IEC 61000-4-3.

a) For noen tjenester er bare opplink-frekvensene inkludert.

b) Bærefrekvensen skal moduleres ved hjelp av et firkantbølgesignal for 50 % av driftssyklusen.

c) Som et alternativ til FM-modulasjon kan 50 % pulsmodulasjon ved 18 Hz brukes. Dette representerer ikke faktisk modulasjon, men er det verst tenkelige scenariet.



Norge:

Besøksadresse:
(Office addresses)
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Tel: (47) 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Norge:

Vareleveringsadresse:
(Storage / Technical dep)
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo
teknisk@invacare.com
www.invacare.no



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology
Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK



Invacare Portugal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



60128473-B 2023-12-04



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®